indusbello
inovação para uma vida saudável

Autoclavável em até 135º C

Linha Odontológica

Consultar Instruções de Utilização

Não Estéril

Manter Afastado da Luz do Sol

Manter Seco

Abritec

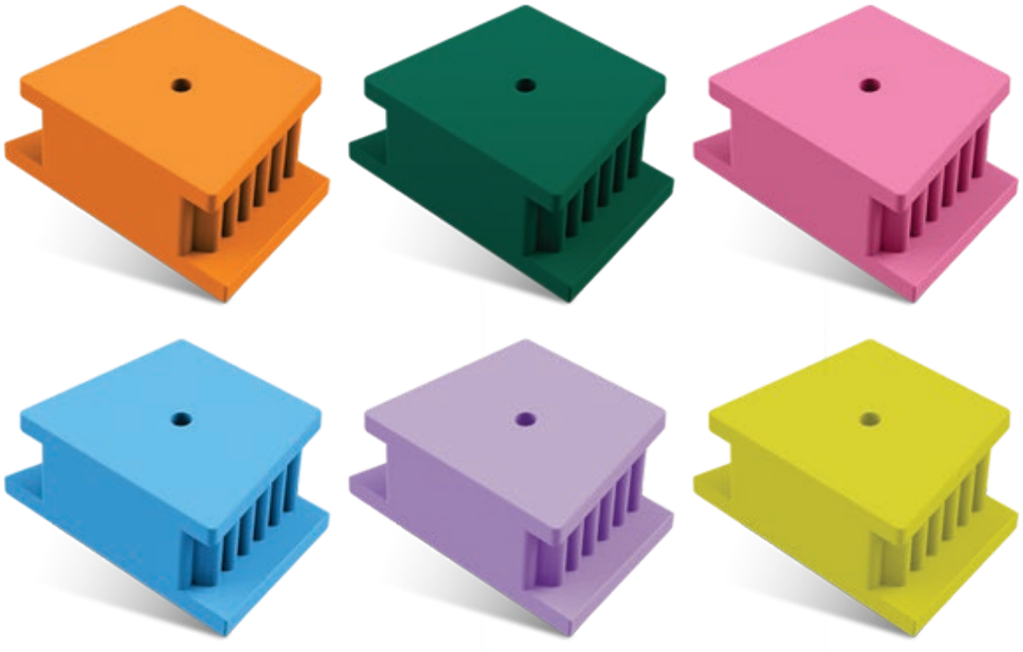

- Dois tamanhos
- Material atóxico e esterilizável, de grande durabilidade
- Disponível em designs e cores variadas
- Maior segurança e facilidade de remoção
- Possui orifício central para fio dental

ABRITEC: Produzido com matéria-prima que proporciona maior conforto aos pacientes. O Abritec Indusbello apresenta um orifício central que possibilita ao profissional amarrar um fio dental, facilitando sua remoção e evitando acidentes durante os procedimentos. Disponível nos modelos adulto e infantil e em várias cores.

INDICAÇÕES: Indicado para manter a boca do paciente aberta, facilitando e proporcionando conforto durante procedimentos odontológicos.

INSTRUÇÕES DE USO: Levar à boca; Manter em posição pelos dentes das hemi-arcadas (superior e inferior), sendo que estas hemi-arcadas devem ser do lado oposto ao dente que será tratado. O lado que tem o trapézio maior deve ficar na vestibular dos dentes.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por 10 minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121ºC a 135ºC, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Silicone atóxico e pigmento.

PRECAUÇÃO: Esterilizar o produto antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave. Produto indicado para esterilização em autoclave. O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data da fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código	Descrição	Apresentação	Registro da ANVISA
101052100901	*Abritec AC Verde*	*1 unid. Adulto + 1 unid. Infantil*	*I 80213420037*
101052100902	*Abritec AC Laranja*	*1 unid. Adulto + 1 unid. Infantil*	
101052100903	*Abritec AC Amarelo*	*1 unid. Adulto + 1 unid. Infantil*	
101052100904	*Abritec AC Azul*	*1 unid. Adulto + 1 unid. Infantil*	
101052100905	*Abritec AC Lilás*	*1 unid. Adulto + 1 unid. Infantil*	
101052100906	*Abritec AC Rosa*	*1 unid. Adulto + 1 unid. Infantil*	

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.
CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 **+55 (43) 3378-8300**
R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397
Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645
Indústria Brasileira

EC REP Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54 | Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net